



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 247, de 5 de outubro de 2021.

(Aditivo às Portarias Inmetro/Dimel nº 0167/2010; nº 0163/2013; nº 008/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos (IPNA), aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994; e,

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 0052600.010012/2021-10 e do sistema Orquestra nº 2074740, resolve:

Art. 1º Incluir a marca CAP LAB nos modelos de IPNA aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 167, de 12 de julho de 2010; nº 163, de 2 de agosto de 2013; nº 8, de 24 de janeiro de 2018; nº 51, de 6 de abril de 2018; nº 218, de 23 de novembro de 2018; nº 279, de 27 de dezembro de 2019; nº 277, de 30 de setembro de 2020; e nº 301, de 23 de outubro de 2020; Requerente BEL EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS LTDA.

Art. 2º Incluir nas Portarias Inmetro/Dimel acima citadas, o Anexo 1 da presente portaria, com as placas de identificação dos modelos de IPNA portando a marca CAP LAB:

Anexo 1 - Placas de Identificação dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020, portando a marca CAP LAB.

Art. 3º Incluir, nas Portarias Inmetro/Dimel acima citadas, o anexo 2 da presente portaria, com os mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 279/2019; e modelos M5-L3202i, M5-L2202i, M5-L1502i, M5-L1002i aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel nº 301/2020, portando a marca CAP LAB.

Anexo 2 - Mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 279/2019 e nº 301/2020 portando a marca CAP LAB.

Art. 4º Incluir, nas Portarias Inmetro/Dimel acima citadas o anexo 3, com os mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; e os modelos LG3202i, LG2202i, LG1502i, LG1002i aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel nº 301/2020.

Anexo 3 - Mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018 e nº 301/2020 portando a marca CAP LAB.

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base nas Portarias Inmetro/Dimel nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020, e seus respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM 07/10/2021, ÀS 10:52, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1029823** e o código CRC **011A3D90**.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 247, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.

BEL Engineering srl, Italia BEL Equipamentos Analíticos Ltda, Piracicaba (SP) Marca Autorizada: Cap-Lab				INMETRO/DIMEL nº Interditada para a venda direta ao público
Modelo:	Num.Se.:	BE2001156		Classe:
Max	e=			
Min	d=	Fabricada: 2021		
24V DC 1000mA		Temp. Range +15°C / +30°C		

MODELOS:

M163, M223, M333, M503, M723, M1702, M2202, M3102, M3502, M4102, M5202 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº0167, 12/07/2010]
 HPB-2285Di-ION, HPB-2265Di-ION, HPB-2245Di-ION, HPB-1265Di-ION, HPB-1245Di-ION, HPB-625i-ION, HPB-425i-ION, HPB-2285Di, HPB-2265Di, HPB-2245Di, HPB-1265Di, HPB-1245Di, HPB-625i, HPB-425i, HPBG-2285Di-ION, HPBG-2265Di-ION, HPBG-2245Di-ION, HPBG-1265Di-ION, HPBG-1245Di-ION, HPBG-625i-ION, HPBG-425i-ION, HPBG-2285Di, HPBG-2265Di, HPBG-2245Di, HPBG-1265Di, HPBG-1245Di, HPBG-625i, HPBG-425i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 218, 23/11/2018]
 M314Ai, M254Ai, M214Ai, M164Ai, M124Ai, MG314Ai, MG254Ai, MG214Ai, MG164Ai, MG124Ai, [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 008, 24/01/2018]

BEL Engineering srl, Italia BEL Equipamentos Analíticos Ltda, Piracicaba (SP) Marca Autorizada: Cap-Lab				INMETRO/DIMEL nº Interditada para a venda direta ao público
Modelo:	Num.Se.:	BE2001156		Classe:
Max	e=			
Min	d=	Fabricada: 2021		
9V DC 1000mA		Temp. Range +15°C / +30°C		

MODELOS:

LW303i, LW203i, LW163i, L303i, L203i, L163i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 0163, 02/08/2013]
 S2202, S1502, S1202, S1002, S622 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 51, 06/04/2018]
 S203, S163, S123 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 277, 30/09/2020]
 M5-RB16001, M5-RB12001, M5-RB10001, M5-RB8001, M5-RB6501 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 279, 27/12/2019]

BEL Engineering srl, Italia BEL Equipamentos Analíticos Ltda, Piracicaba (SP) Marca Autorizada: Cap-Lab				INMETRO/DIMEL nº Interditada para a venda direta ao público
Modelo:	Num.Se.:	BE2001156		Classe:
Max	e=			
Min	d=	Fabricada: 2021		
9V DC 1000mA		Temp. Range +15°C / +35°C		

MODELOS:

LG3202i, LG2202i, LG1502i, LG1002i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 301, 23/10/2020]
 M5-L3202i, M5-L2202i, M5-L1502i, M5-L1002i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 301, 23/10/2020]

QUADRO ANEXO ÀS PORTARIAS INMETRO/DIMEL Nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020



REQUERENTE: BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA

Placas de Identificação dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 0167/2010; nº 0163/2013; nº 008/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020, portando a marca CAP LAB.

ANEXO 1



M5-L3202i, M5-L2202i, M5-L1502i, M5-L1002i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 301, 23/10/2020]



M5-RB16001, M5-RB12001, M5-RB10001, M5-RB8001, M5-RB6501 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 279, 27/12/2019]



RB16001, RB12001, RB10001, RB8001, RB6501 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 279, 27/12/2019]


QUADRO ANEXO ÀS PORTARIAS INMETRO/DIMEL Nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020



REQUERENTE: BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA

Mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 279/2019 e nº 301/2020 portando a marca CAP LAB.

ANEXO 2

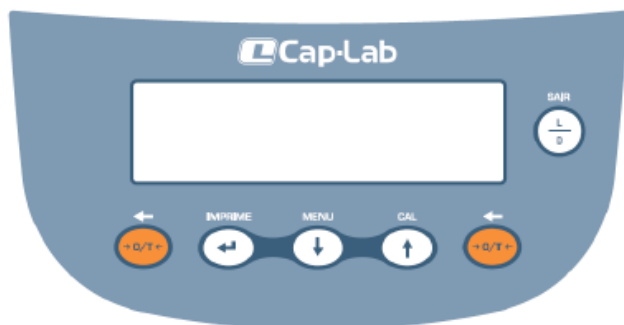


M163, M223, M333, M503, M723, M1702, M2202, M3102, M3502, M4102, M5202 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº0167, 12/07/2010]

LW303i, LW203i, LW163i, L303i, L203i, L163i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 0163, 02/08/2013]

HPB-2285Di-ION , HPB-2265Di-ION, HPB-2245Di-ION, HPB-1265Di-ION, HPB-1245Di-ION, HPB-625i-ION, HPB-425i-ION, HPB-2285Di, HPB-2265Di, HPB-2245Di, HPB-1265Di, HPB-1245Di, HPB-625i, HPB-425i , [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 218, 23/11/2018]


M314Ai, M254Ai, M214Ai, M164Ai, M124Ai [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 008, 24/01/2018]

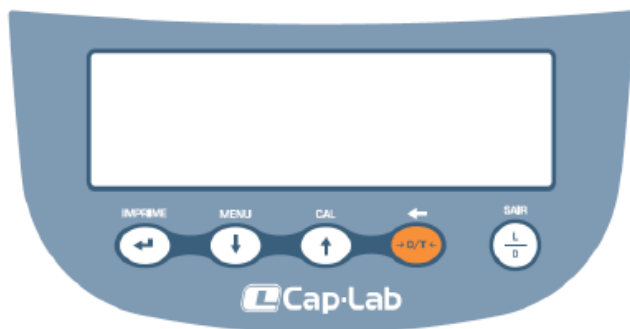

HPBG-2285Di-ION, HPBG-2265Di-ION, HPBG-2245Di-ION, HPBG-1265Di-ION, HPBG-1245Di-ION, HPBG-625i-ION, HPBG-425i-ION, HPBG-2285Di, HPBG-2265Di, HPBG-2245Di, HPBG-1265Di, HPBG-1245Di, HPBG-625i, HPBG-425i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 218, 23/11/2018]

LG3202i, LG2202i, LG1502i, LG1002i [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 301, 23/10/2020]

MG314Ai, MG254Ai, MG214Ai, MG164Ai, MG124Ai, [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 008, 24/01/2018]

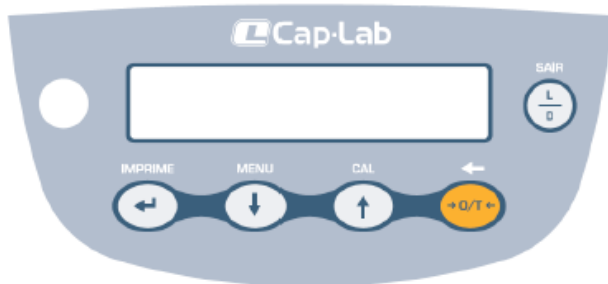

S2202, S1502, S1202, S1002, S622 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 51, 06/04/2018]

S203, S163, S123 [Portaria INMETRO/DIMEL Nº 277, 30/09/2020]

QUADRO ANEXO ÀS PORTARIAS INMETRO/DIMEL Nº 167/2010; nº 163/2013; nº 8/2018; nº 51/2018; nº 218/2018; nº 279/2019; nº 277/2020; e nº 301/2020



REQUERENTE: BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA

Mostradores dos modelos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 0167/2010; nº 0163/2013; nº 008/2018; nº 51/2018; nº 218/2018 e nº 301/2020 portando a marca CAP LAB.

ANEXO 3

