



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 125, de 13 de abril de 2022.

(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 177/2021)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidor de volume de água, tipo mecânico, aprovado pela Portaria Inmetro nº 295/2018; e,

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 0052600.002392/2022-08 e do sistema Orquestra nº 2198367, resolve:

Art. 1º Modificar a família de modelos VS, aprovada pela Portaria Inmetro/Dimel nº 177, de 10 de agosto de 2021, com a inclusão do opcional de válvula de retenção anti refluxo.

Art. 2º Dar nova redação ao item 5 "ANEXOS" da Portaria Inmetro/Dimel nº 177, de 10 de agosto de 2021, com a inclusão dos seguintes desenhos:

(...)

Anexo 5 - Vista em corte frontal com o opcional de válvula de retenção anti refluxo;" (NR).

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel nº 177, de 10 de agosto de 2021, e seus respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
13/04/2022, ÀS 13:01, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCELO LUIS FIGUEIREDO MORAIS

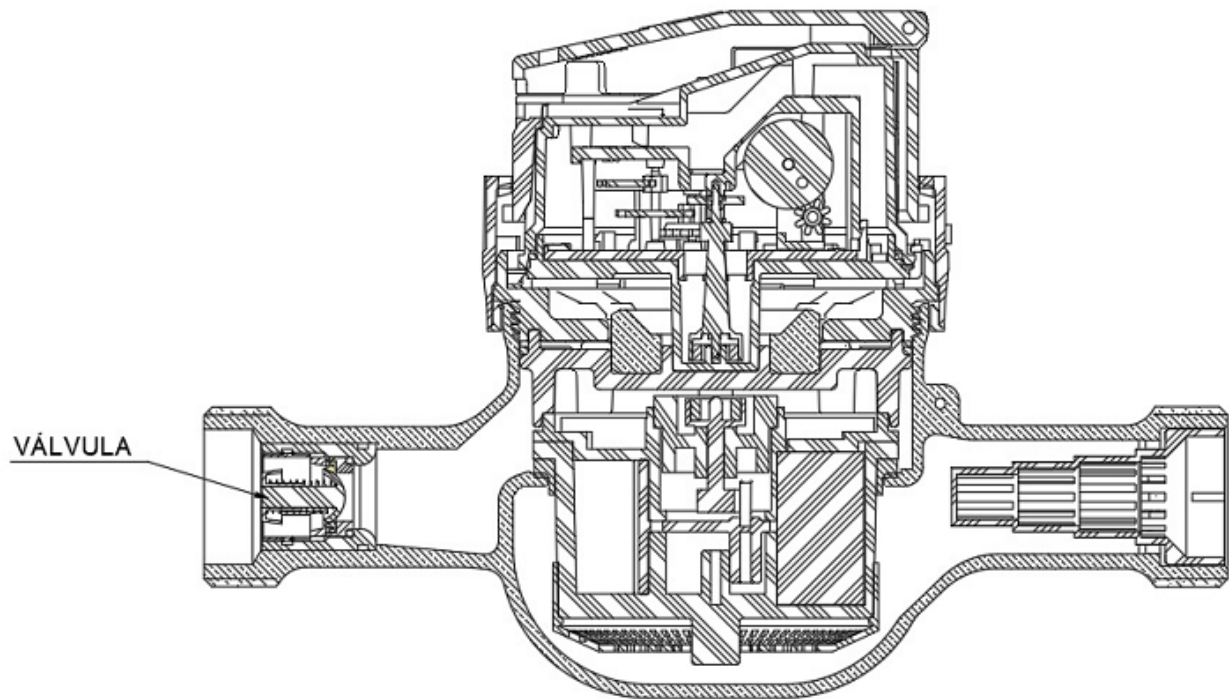
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal, Substituto(a)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1179817** e o código CRC **14C1233E**.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 125, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Nota:

- Inclusão da válvula aplicável a todas as opções de relojoarias e carcaças

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 177, DE 10 DE AGOSTO DE 2021



REQUERENTE: SAGA MEDIÇÃO LTDA.

VISTA EM CORTE FRONTAL COM O OPCIONAL DE VÁLVULA DE RETENÇÃO ANTI REFLUXO

ANEXO 5

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001