



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel n.º 31, de 24 de fevereiro de 2023.

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada por meio da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para sistemas de medição dinâmica equipados com medidores para quantidades de líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 291/2021; e,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 0052600.011331/2022-23 e do sistema Orquestra n.º 2375673, resolve:

Art. 1º Aprovar o modelo 4 Inch Coriolis Flow metering System, de sistema de medição e abastecimento para fluidos-óleo, Classe de exatidão 1.0, marca ODS Metering Systems, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

Nome: ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

Endereço: Avenida Pierre Simon de Laplace 830, Bloco 1

Technopark - Campinas - SP CEP: 13069-320

CNPJ: 09522417/0001-99

2 FABRICANTE

Nome: ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

Endereço: Avenida Pierre Simon de Laplace 830, Bloco 1

Technopark - Campinas - SP CEP: 13069-320

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Instrumento de medição: sistema de medição e abastecimento para fluidos-óleo

Marca: ODS Metering Systems

Modelo: 4 Inch Coriolis Flow Metering System

Classe de exatidão: 1.0

4 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes características:

a) Classe de Exatidão: 1.0

b) Tramos de medição: 1 tramo de medição

c) Padrão de calibração: medidor *master*, com alinhamento individual, ou provador compacto ou calibração externa em laboratório acreditado

d) Medidor de vazão (primário): medidor de vazão mássica, por efeito Coriolis, modelo CMF350, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel nº 98/2006 e aditivos pelas Portarias Inmetro/Dimel nº 216/2018 e 285/2020

- e) Trechos retos: não aplicável
- f) Diâmetro do medidor de vazão: 100 mm
- g) Computador de vazão: marca Spirit, modelo FLOW X/C, aprovado por Portaria Inmetro/Dimel nº 64/2020, com configurações definidas nos anexos desta portaria
- h) Frequência máxima de pulsos (HF): 10 kHz para onda quadrada
- i) Frequência mínima de pulsos (LF): 1 Hz para onda quadrada
- j) Padrão de cálculo: API/MPMS 11.1
- k) Vazão de operação do sistema: 3,2 a 180 m³/h
- l) Temperatura de operação do fluido: 85 a 125 °C
- m) Pressão de operação do fluido: 0 a 11 barg
- n) Massa específica do fluido: 830 a 882kg/m³
- o) Viscosidade do fluido: 23,35 a 141 cP
- p) Faixa de temperatura ambiente: 0 a 50 °C
- q) Fluido com que trabalha: petróleo cru
- r) Quantidade mínima mensurável: 5 kg

5 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

5.1 Descrição: Sistema de medição aplicável à medição de óleo bruto, cujo computador de vazão recebe sinais elétricos e de comunicação de transdutores externos relativos às variáveis do processo (pressão, temperatura, vazão, composição do líquido). A partir da vazão/volume de operação, obtida pelo medidor primário (mássico, por efeito Coriolis) e entregue ao computador de vazão, este promove a conversão para condições de base, utilizando-se dos algoritmos presentes no seu firmware. Todas as operações são registradas na trilha de auditoria do computador de vazão.

5.2 As conversões dos valores dos volumes são automáticas e efetuadas continuamente, sendo a metodologia e algoritmo de cálculo do fator de conversão selecionado na configuração do computador de vazão e definidos pelas normas descritas no seguinte item do Anexo D da Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 10 de junho de 2013:

5.2.1 Item 7.27, "API/MPMS 11.1. Temperature and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products, and Lubricating Oils".

5.3 Comunicação: a leitura de quaisquer informações ou mesmo valores totalizados pode ser feita através do mostrador do computador de vazão.

5.4 Fonte de Alimentação: O computador de vazão e a instrumentação devem ser alimentados por uma fonte de alimentação DC, com saída de 24 Vcc.

6 CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

6.1 A instalação do computador de vazão deve observar as recomendações do fabricante, bem como as exigências constantes na respectiva portaria de aprovação de modelo e as disposições da Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 10 de junho de 2013.

6.2 A presente aprovação não contempla módulos de expansão do sistema ou de suas partes, que não tenham influência metrológica, como: módulos de saídas analógicas ou com funções de controle, bem como não contempla as entradas de sinais digitais deles.

6.3 As configurações do computador de vazão são aquelas apresentadas nos anexos desta portaria.

6.4 A instalação do medidor de vazão deve atender às especificações da respectiva portaria de aprovação e deste anexo.

6.5 A presente aprovação não substitui a necessária certificação das partes do sistema, quando utilizado em atmosferas potencialmente explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis.

7 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

7.1 Para o sistema, devem ser marcadas na carcaça ou em uma placa de identificação, de forma clara, indelével e sem ambiguidade, as seguintes inscrições:

- a) Marca ou nome do requerente
- b) Designação do modelo

- c) Número de série e ano de fabricação
- d) Número da portaria de aprovação de modelo, na forma: "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano)
- e) Classe de exatidão
- f) Fluido de trabalho
- g) Faixa de operação de vazão
- h) Faixa de operação de temperatura
- i) Faixa de operação de pressão
- j) Faixa de operação de viscosidade
- k) Faixa de operação de densidade
- l) Quantidade mínima mensurável

7.2 Cada componente ou subsistema que tenha sido objeto de aprovação de modelo deve portar sua respectiva placa de identificação, respeitando os respectivos regulamentos e portarias de aprovação.

8 CONTROLE LEGAL DOS INSTRUMENTOS

8.1 A utilização do referido sistema de medição nas medições fiscais, de apropriação e de transferência de custódia de líquidos está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes nesta Portaria de Aprovação de Modelo, na Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 10 de junho de 2013 e na Portaria Inmetro n.º 291, de 07 de julho de 2021.

8.2 A critério do requerente, a verificação pode ser realizada em uma ou duas fases, conforme Portaria Inmetro n.º 291, de 07 de julho de 2021 e documentação complementar emitida pelo Inmetro (NIE ou NIT).

8.3 As marcas de selagem devem seguir as respectivas portarias de aprovação de modelo das partes que tenham sido objeto de aprovação de modelo, bem como os pontos indicados no desenho anexo à presente Portaria. O computador de vazão possui também selagem eletrônica.

8.4 Verificações:

8.4.1 Verificação inicial: o sistema de medição deve, previamente à sua colocação em serviço, ser objeto de um procedimento de verificação inicial, onde serão analisadas, no mínimo, as seguintes funções:

- a) Leitura de pulsos
- b) Totalização de um tramo de medição
- c) Segurança de software (sistema de senha e relatório de alterações executadas pelo usuário)
- d) Trilha de auditoria do computador de vazão
- e) Teste de malha
- f) Checagem das configurações do computador de vazão
- g) Verificação da conformidade do sistema construído ao modelo aqui aprovado
- h) Teste do padrão de calibração dos medidores primários
- i) Ensaios complementares previstos na documentação pertinente (NIE ou NIT)
- j) Inspeção da documentação e respectivos certificados de calibração

9 ANEXOS

Anexo 1 – Representação do sistema de medição

Anexo 2 – Vista lateral

Anexo 3 – Trechos de medição

Anexo 4 – Configurações do computador de vazão – parte 1

Anexo 5 – Configurações do computador de vazão – parte 2

Anexo 6 – Configurações do computador de vazão – parte 3

Anexo 7 – Configurações do computador de vazão – parte 4

Anexo 8 – Plano de selagem do medidor de vazão CMF050

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
24/02/2023, ÀS 16:26, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCELO LUIS FIGUEIREDO MORAIS

Diretor da Diretoria de Metrologia Legal, Substituto(a)


A autenticidade deste documento pode ser conferida no
site

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **1451356** e o código CRC
18110AFB.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

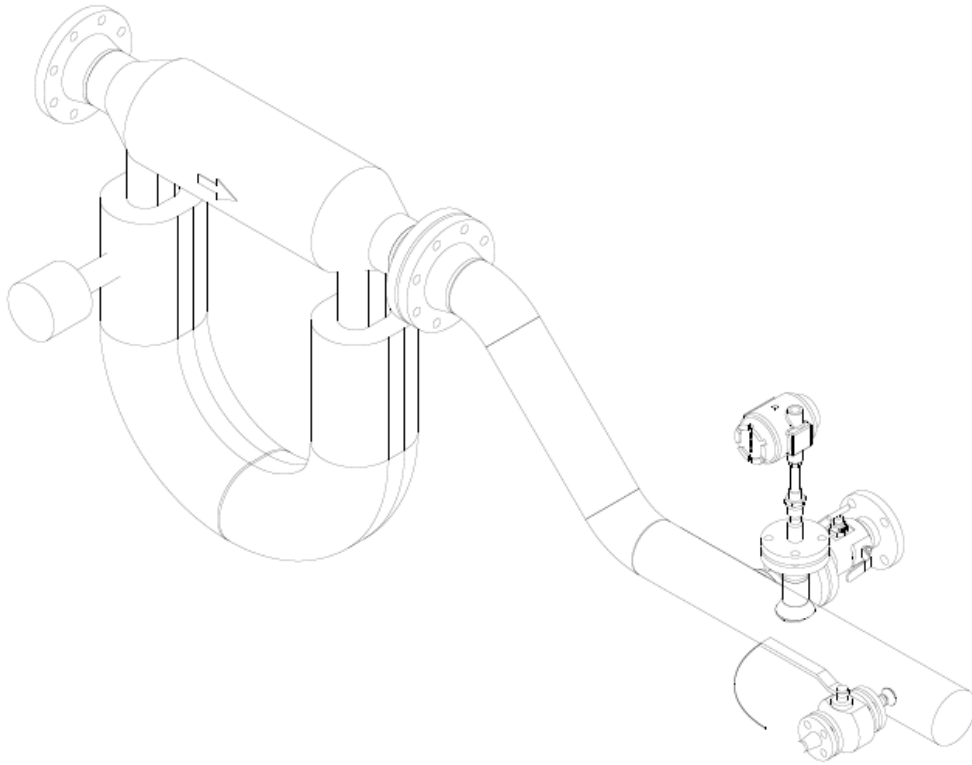

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.




REQUERENTE: ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

**VISTA FRONTAL
MODELO**

ANEXO 1

4 INCH CORIOLIS FLOW METER

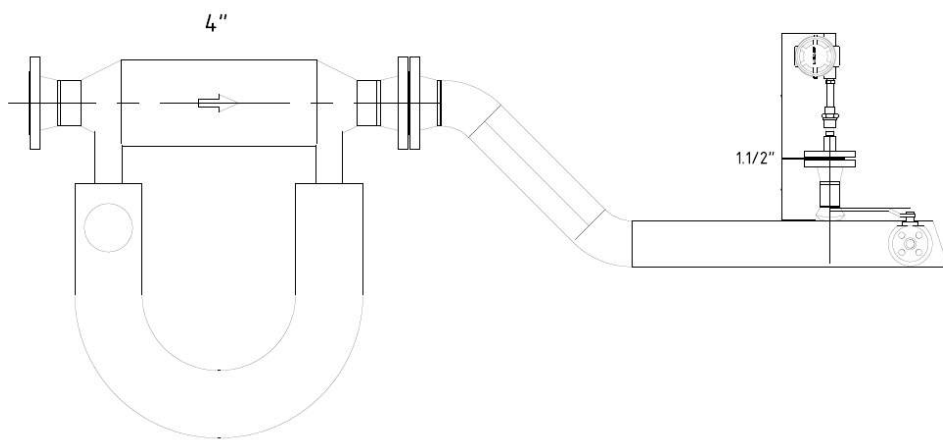


QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.


**REQUERENTE:** ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

VISTA LATERAL

ANEXO 2

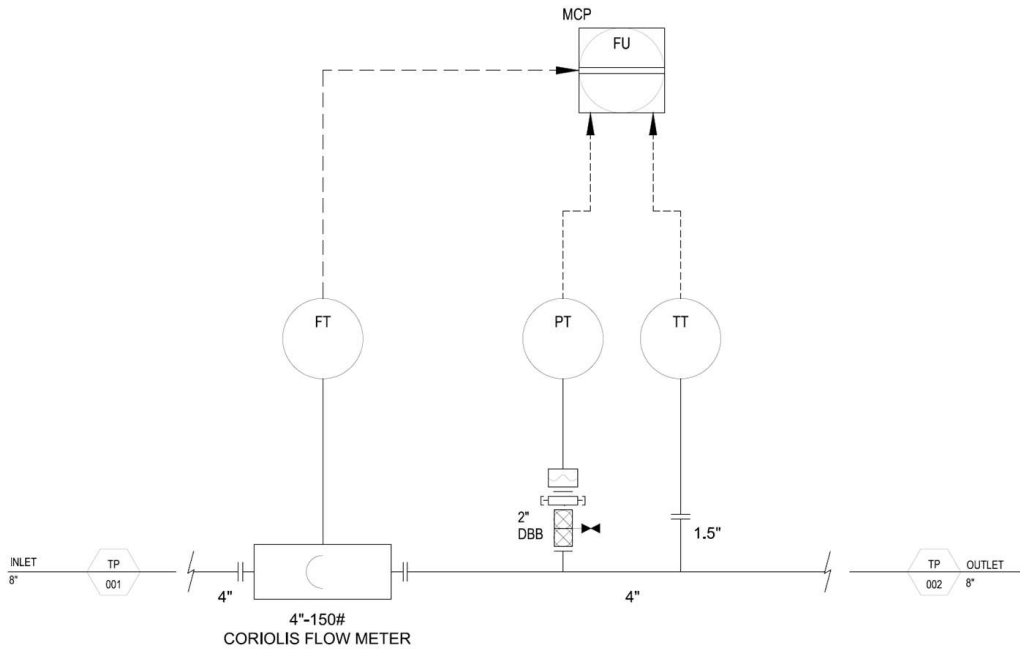

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

	REQUERENTE: ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
	TRECHOS DE MEDIÇÃO
	ANEXO 3

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Overall setup (Common settings)				
	Flow computer type	3: Proving / run		
	Common product and batching	0: Disabled		
	Common density input	0: Disabled		
	Common BSW input	0: Disabled		
	Common viscosity input	0: Disabled		
	Number of products	1		1 .. 16
	Number of local meter runs	1: 1 meter run		
	Pressure ATM Global	1.01325	bar(s)	
	Pressure reference Global	1.01325	bar(s)	
	Density of water	999.23	kg/m3	950 .. 1050
	Viscosity reference temperature	20	°C	
	Base temperature	20	°C	0 .. 40
	OBM-R22 base temperature - ethanol	20	°C	0 .. 40
	Volume total roll-over value	1000000000	m3	0 .. 1000000000000
	Mass total roll-over value	1000000000	tonne	0 .. 1000000000000
	Mass totals type	1: Mass in vacuum		
	Reverse totals	0: No		
	Disable totals if meter is inactive	1: Yes		
	Set flow rate to 0 if meter is inactive	1: Yes		
	Reset maint. totals on entering maint. mode	0: No		
	Disable alarms if meter is inactive	0: No		
	Disable alarms in maintenance mode	1: Yes		
	Deviation alarm delay	10	s	
	Batch quantity type	1: Volume		
	Allow batch end if meter is active	0: No		
	Allow batch end if batch total 0	1: Yes		
	Shift batch stack on batch end	0: Disabled		
	Batch start command	1: Enabled		
	All totals inactive after batch end	0: No		
	Station batch recalculation	0: Disabled		
	Loading functionality	0: Disabled		
	MD compliance	0: Disabled		
	Allow manual overrides	1: Yes		
	Date format	1: dd/mm/yy		
	Time set inhibit time	30	s	0 .. 59
	SHTP time synchronization	0: Disabled		
	Generate batch / loading archive data	1: Yes		
	Generate hourly archive data	0: No		
	Generate hourly archive data	1: Yes		
	Generate daily archive data	0: No		
	Generate period A archive data	0: No		
	Generate period B archive data	0: No		
	Generate prove archive data	0: No		
	Memory low alarm limit	4000	KB	

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Analog inputs				
	Analog input 1 tag	664-PT-2100		
	Analog input 1 input type	1: 4-20 mA		
	Analog input 1 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 1 full scale	10		
	Analog input 1 zero scale	0		
	Analog input 1 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 1 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0
	Analog input 2 tag	664-TT-2100		
	Analog input 2 input type	1: 4-20 mA		
	Analog input 2 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 2 full scale	50		
	Analog input 2 zero scale	0		
	Analog input 2 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 2 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0
	Analog input 3 tag	664-AT-2067		
	Analog input 3 input type	3: 1-5 Vdc		
	Analog input 3 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 3 full scale	10		
	Analog input 3 zero scale	0		
	Analog input 3 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 3 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0
	Analog input 4 tag			
	Analog input 4 input type	1: 4-20 mA		
	Analog input 4 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 4 full scale	15		
	Analog input 4 zero scale	0		
	Analog input 4 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 4 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0
	Analog input 5 tag			
	Analog input 5 input type	1: 4-20 mA		
	Analog input 5 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 5 full scale	50		
	Analog input 5 zero scale	0		
	Analog input 5 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 5 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0
	Analog input 6 tag			
	Analog input 6 input type	3: 1-5 Vdc		
	Analog input 6 averaging	1: Arithmetic mean		
	Analog input 6 full scale	10		
	Analog input 6 zero scale	0		
	Analog input 6 high fail limit	102.4	%span	100 .. 112.5
	Analog input 6 low fail limit	-2.4	%span	-25 .. 0

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

**REQUERENTE:** ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DE VAZÃO – PARTE 1

ANEXO 4

The image displays three screenshots of a software configuration interface, likely for a process control system. Each screenshot shows a tree view on the left and a parameter list on the right.

Top Screenshot: Digital IO assign

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Flow rates	Product	664-FI-2100		
Temperature	Digital 1 tag	664-FI-2100		
Pressure	Digital 1 signal type	3: Pulse input 1A		
Density	Digital 2 tag	664-FI-2100		
BSW	Digital 2 signal type	4: Pulse input 1B		
Batch	Digital 3 tag	664-FI-2100		
Proving	Digital 3 signal type	17: Prover bus pulse output A		
Period data	Digital 4 tag	---		
Configuration	Digital 4 signal type	0: Not used		
Module 1	Digital 5 tag	---		
Configuration	Digital 5 signal type	0: Not used		
Analog inputs	Digital 6 tag	---		
PT100 inputs	Digital 6 signal type	0: Not used		
Digital IO assign	Digital 7 tag	---		
Digital IO settings	Digital 7 signal type	0: Not used		
Analog outputs	Digital 8 tag	664-XA-0001		
Diagnostics	Digital 8 signal type	2: Digital output		
Calibration	Digital 9 tag	---		
Force ID	Digital 9 signal type	0: Not used		
Calibration	Digital 10 tag	---		
Communication	Digital 10 signal type	0: Not used		
System	Digital 11 tag	---		
Serialnumbers	Digital 11 signal type	---		
	Digital 12 tag	---		
	Digital 12 signal type	0: Not used		
	Digital 13 tag	---		
	Digital 13 signal type	0: Not used		
	Digital 14 tag	664-XA-0001 (UNIT IV)		
	Digital 14 signal type	1: Digital input		
	Digital 15 tag	664-ZS-0001 (START IV OUT)		
	Digital 15 signal type	2: Digital output		
	Digital 16 tag	664-ZS-0001 (START IV IN)		
	Digital 16 signal type	21: Prover B common/start (A)		

Middle Screenshot: Pulse inputs

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Flow rates	Pulse inputs/Pulse input 1			
Temperature	Dual pulse fidelity level	1: Level A		
Pressure	Fall back to secondary pulse	1: Yes		
Density	Error pulses limit	0		
BSW	Good pulses reset limit	2000		
Batch	Error rate limit	1	%	
Proving	Dual pulse fidelity threshold	5	Hz	
Period data	Lowest discernable input frequency	0.1	Hz	0.01.. 1
Configuration	Prover bus pulse output A	1: Enabled		
Module 1	Prover bus pulse output B	1: Enabled		
Configuration	Pulse inputs/Pulse input 2			
Analog inputs	Dual pulse fidelity level	1: Level A		
PT100 inputs	Fall back to secondary pulse	1: Yes		
Digital IO assign	Error pulses limit	0		
Digital IO settings	Good pulses reset limit	2000		
Pulse inputs	Error rate limit	1	%	
Pulse input 1	Dual pulse fidelity threshold	5	Hz	
Pulse input 2	Lowest discernable input frequency	0.1	Hz	0.01.. 1
Pulse input 3	Dual pulse fidelity level	1: Level A		
Pulse input 4	Fall back to secondary pulse	1: Yes		
Time period output	Error pulses limit	0		
Analog outputs	Good pulses reset limit	0		
Frequency outputs	Error rate limit	0	%	
Diagnostics	Dual pulse fidelity threshold	5	Hz	
Calibration	Lowest discernable input frequency	0.1	Hz	0.01.. 1
Force ID	Dual pulse fidelity level	1: Level A		
Calibration	Fall back to secondary pulse	1: Yes		
Communication	Error pulses limit	0		
System	Good pulses reset limit	0		
Serialnumbers	Error rate limit	0	%	
	Dual pulse fidelity threshold	5	Hz	
	Lowest discernable input frequency	0.1	Hz	0.01.. 1

Bottom Screenshot: Products

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Flow rates	Product 1 name	Crude Oil		
Temperature	Product 1 density conversion method	ISO 91/46A:2007 Crude		
Pressure	Product 1 separate CII and GII	1: Enabled		
Density	Product 1 standard density override	859.17		
BSW	Product 1 standard density override	2: density [kg/m3]		
Batch	Product 1 standard density override unit type	1		0.8.. 1.2
Proving	Product 1 density correction factor	1		
Period data	Product 1 equilibrium pressure method	2: Standard		
Configuration	Product 1 compressibility F override	0: Disabled		
Overall setup	Product 1 isentropic exponent override	1.3		0.. 10
Run 1	Product 1 dynamic viscosity override	1E-05	P.a.s	0.. 1
Run 2	Product 1 viscosity constant A	0		
Proving	Product 1 viscosity constant B	0		
Analog inputs	Product 1 viscosity constant C	0.7		
Module 1	Product 1 auto select density high limit	0	kg/m3	
Configuration	Product 1 auto select density low limit	0	kg/m3	
Diagnostics				
Calibration				
Force ID				
Calibration				
Communication				
System				
Serialnumbers				

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

**REQUERENTE:** ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DE VAZÃO – PARTE 2

ANEXO 5

Location	Parameter	Value	Unit	Range
	Run 1 setup			
	Run 1 Meter device type	1: Pulse		
	Run 1 Meter temperature transmitter(s)	0: Single		
	Run 1 Meter pressure transmitter(s)	0: Single		
	Run 1 Observed density input type	0: None		
	Run 1 Standard density input type	1: From product table		
	Run 1 Multiple products	0: Disabled		
	Run 1 Single product number	1		

Location	Parameter	Value	Unit	Range
	Flow meter\Meter data			
	Run 1 Meter tag	664-FT-2100		
	Run 1 Meter ID	664-FT-2100		
	Run 1 Meter serial nr	TBD		
	Run 1 Meter manufacturer	M&T		
	Run 1 Meter model	HTM16		
	Run 1 Meter size	16"		
	Flow meter\Pulse input			
	Run 1 Pulse input module	-1: Local module		
	Run 1 Pulse input index	1: Pulse input 1		
	Run 1 Pulse input quantity type	1: Volume		
	Run 1 Meter active threshold frequency	5	Hz	
	Run 1 Enable meter inactive custom condition	0: Disabled		
	Run 1 Custom pulse increment	0: Disabled		

Location	Parameter	Value	Unit	Range
	Flow meter\Meter K-factor\K-factor curve fwd			
	Run 1 Fwd meter K-factor curve date	1/1/2000 12:00:00 AM		
	Run 1 Point 1 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 1 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 2 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 2 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 3 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 3 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 4 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 4 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 5 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 5 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 6 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 6 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 7 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 7 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 8 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 8 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 9 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 9 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 10 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 10 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 11 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 11 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Run 1 Point 12 - Fwd frequency	0	Hz	
	Run 1 Point 12 - Fwd meter K-factor	0	Pls/unit	
	Flow meter\Meter factor\Meter factor setup			
	Run 1 Type of input value	1: Meter factor [-]		
	Run 1 Meter factor / error curve	0: Disabled		
	Run 1 Custom meter factor	0: Disabled		
	Run 1 Prove required flags	0: Disabled		
	Flow meter\Meter factor\Forward meter factor			
	Run 1 Fwd MF / error	1		
	Flow meter\Data valid input			
	Run 1 Data valid input type	0: None		
	Flow meter\Meter body correction			
	Run 1 Meter body correction	0: Disabled		
	Flow meter\Viscosity correction			
	Run 1 Viscosity correction	0: Disabled		
	Flow meter\Indicated totalizers			
	Run 1 Preset Fwd indicated totalizer value	0		
	Flow meter\Serial mode			
	Run 1 Serial mode input type	0: None		

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

**REQUERENTE:** ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DE VAZÃO – PARTE 3

ANEXO 6

Parameters

Location	Parameter	Value	Unit	Range
BSW	Run 1 BSAW input type	2: Analog input		
	Run 1 BSAW analog input module	-1: Local module		
	Run 1 BSAW analog input channel	3		1..6
	BSW transmitter fall back type RUN 1	1: Last good value		
	Run 1 BSAW input frozen time	0	s	>= 0

Parameters

Location	Parameter	Value	Unit	Range
Temperature	Run 1 Meter temperature A input type	2: Analog input		
	Run 1 Meter temperature A analog/PT100 input module	-1: Local module		
	Run 1 Meter temperature A analog/PT100 input channel	2		1..6
	Temperature transmitter fall back type RUN 1	1: Last good value		
	Run 1 Meter temperature A input frozen time	0	s	>= 0

Parameters


Location	Parameter	Value	Unit	Range
Pressure	Run 1 Meter pressure A input type	2: Analog input		
	Run 1 Meter pressure input units	1: gauge		
	Run 1 Meter pressure A analog input module	-1: Local module		
	Run 1 Meter pressure A analog input channel	1		1..6
	Run 1 Meter pressure A HART internal device nr.	0: No device		
	Run 1 Meter pressure A HART variable	1		1..4
	Run 1 Meter pressure A HART to analog fallback	0: Disabled		
	Run 1 Smart meter internal device nr.	0: No device		
	Run 1 Meter pressure fallback type	3: Override value		
	Run 1 Meter pressure fallback value	0	kPa	
	Run 1 Meter pressure A input frozen time	0	s	>= 0

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.


**REQUERENTE:** ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA

CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DE VAZÃO – PARTE 4

ANEXO 7

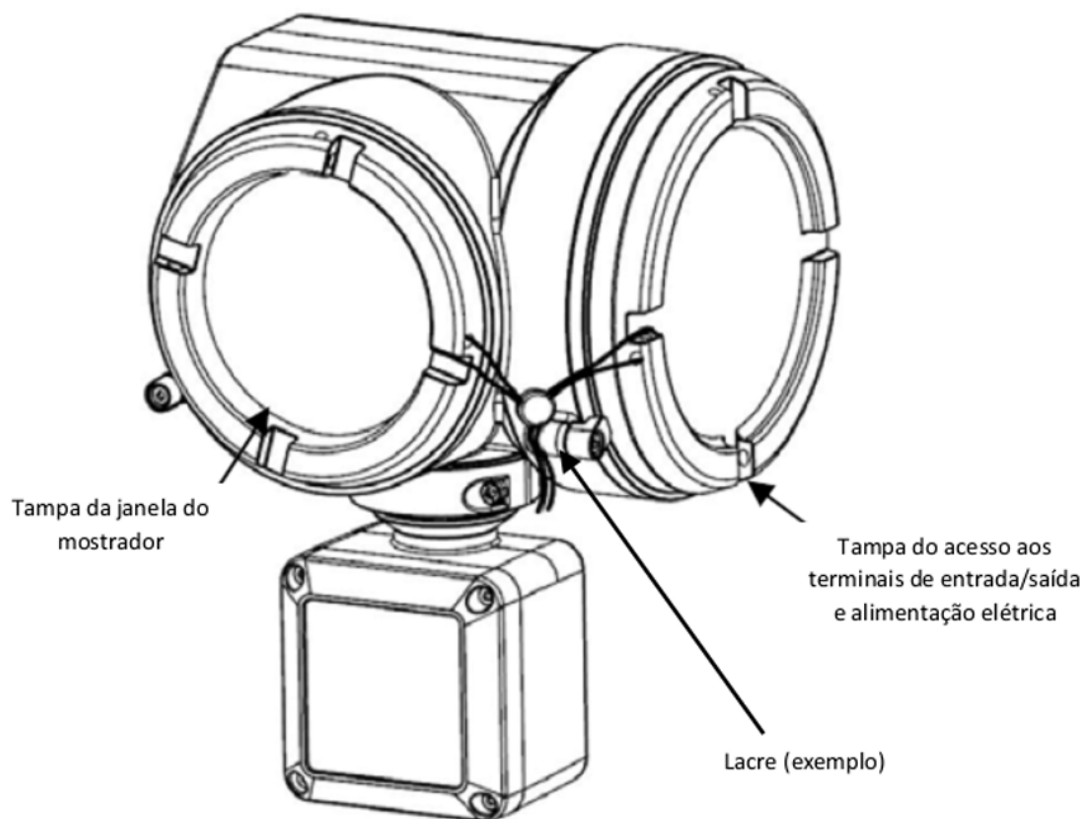**NOTAS:**

1. Podem ser providos outros recursos de selagem se necessário de acordo com a regulamentação vigente e orientação do INMETRO.
2. O lacre especificado nos regulamentos vigentes é fornecido pelo INMETRO ou seus órgãos delegados durante o processo de verificação Inicial

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 31, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.	
	REQUERENTE: ODS DO BRASIL SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
	PLANO DE SELAGEM DO MEDIDOR DE VAZÃO CMF050
	ANEXO 8

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001